



Lab Camera Pulita




CAMERA PULITA 223,65 mq

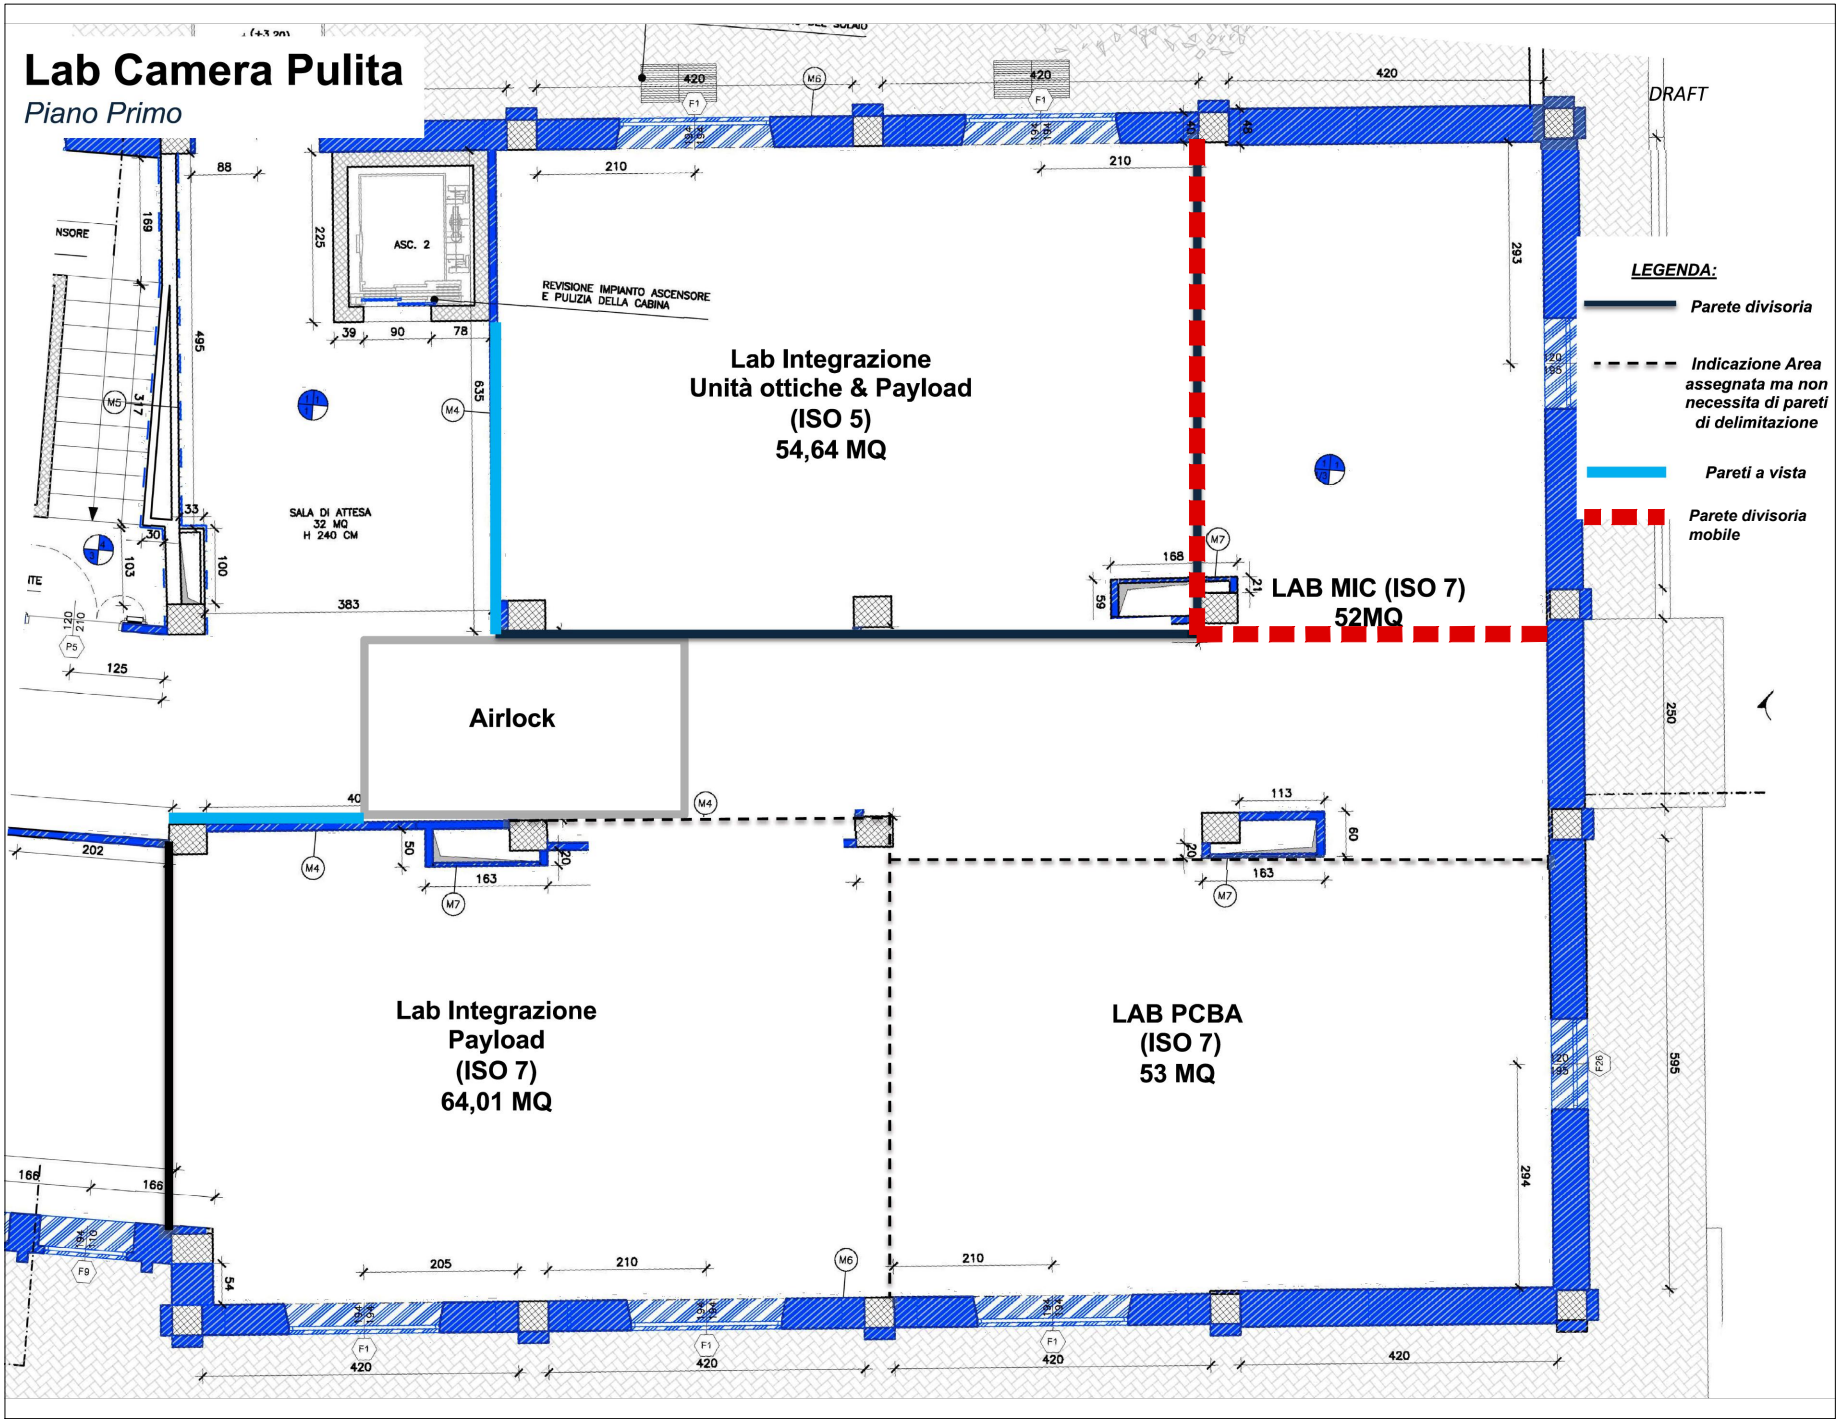


CONFIGURAZIONE 1

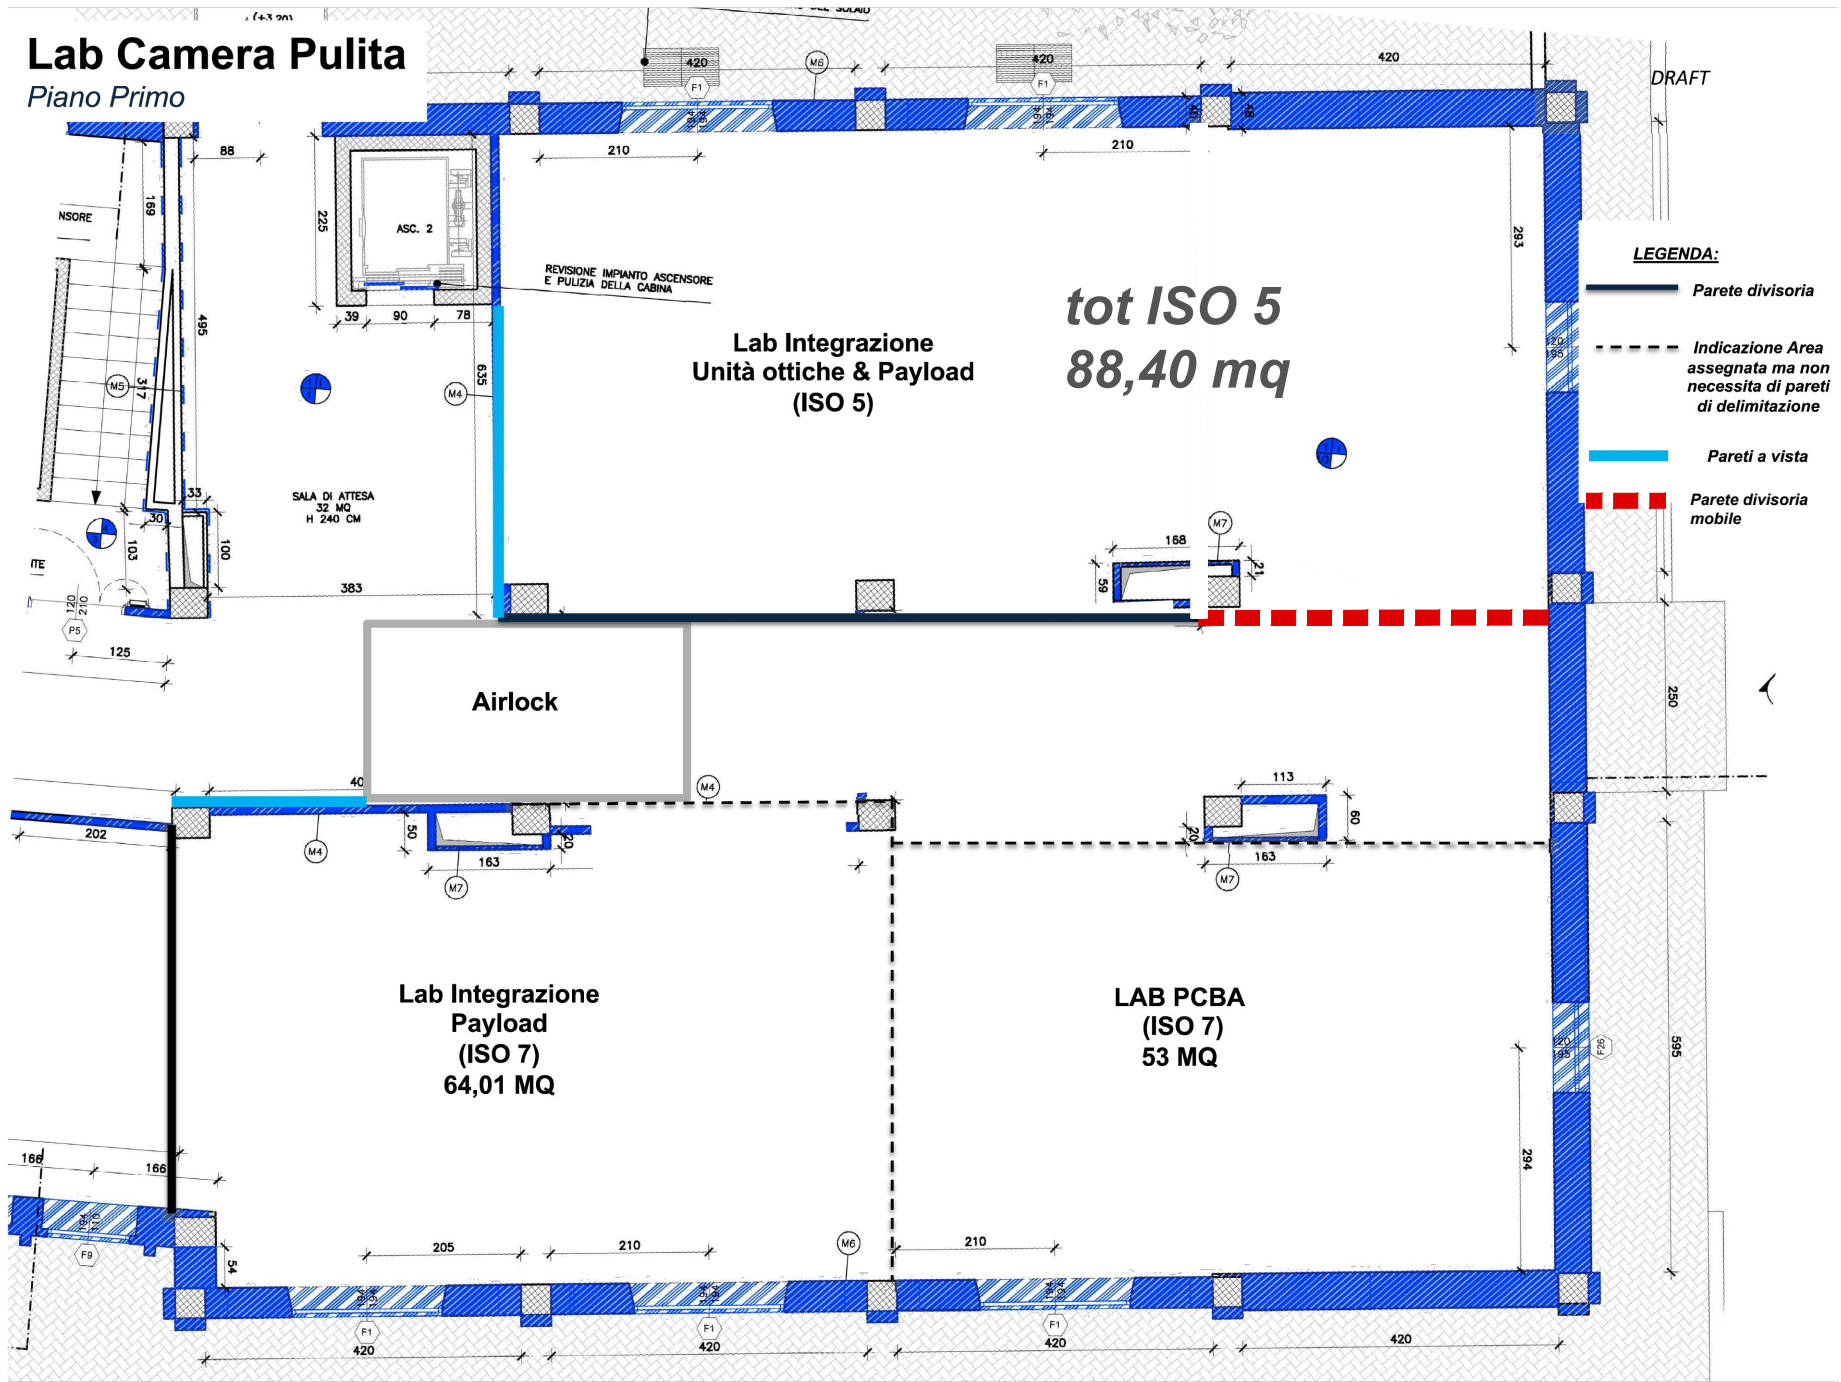


CONFIGURAZIONE 2

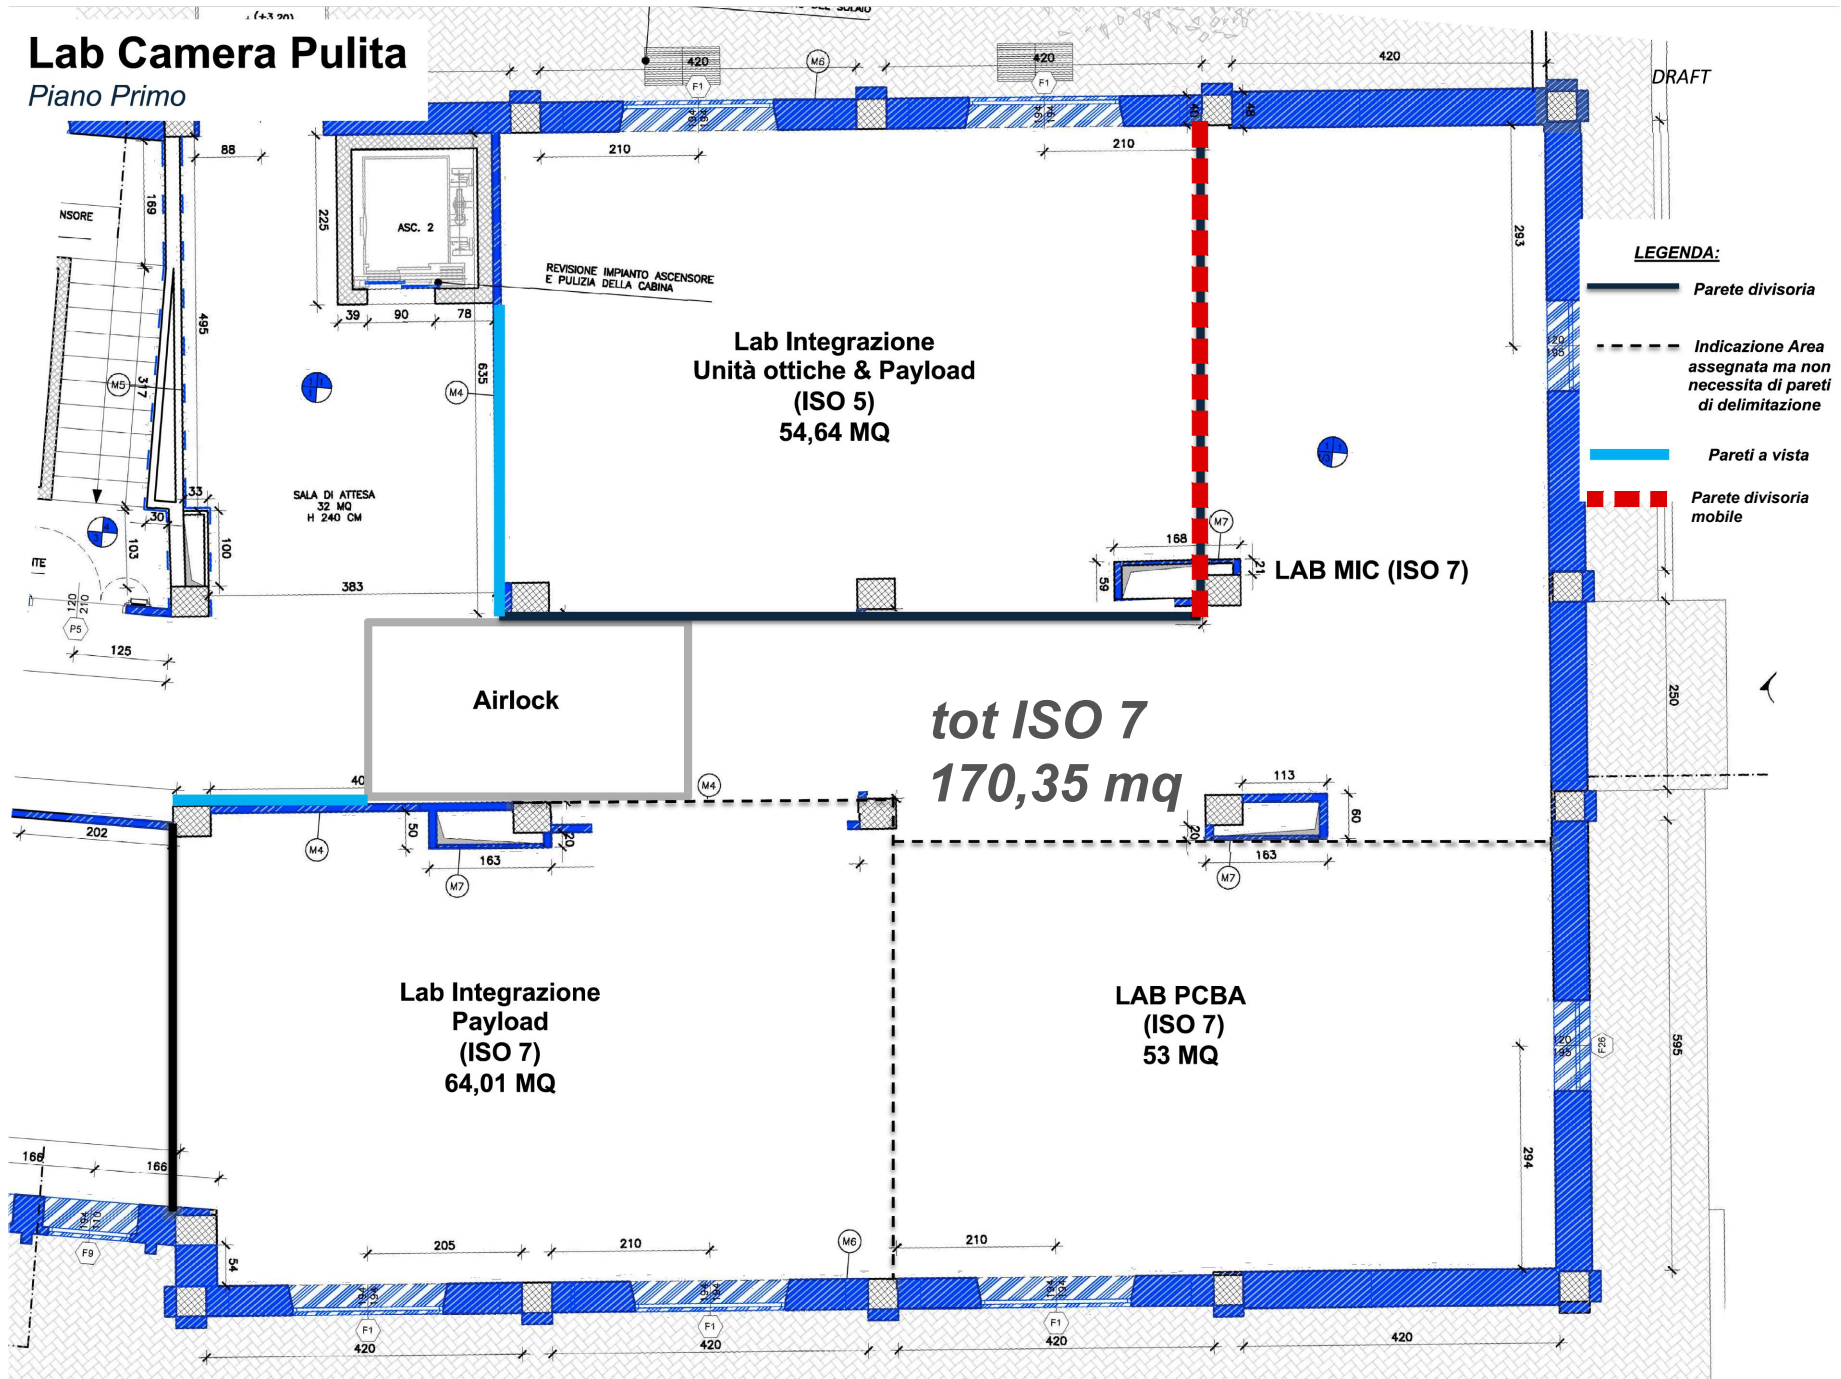

Lab Integrazione Unità ottiche & Payload - ISO 5

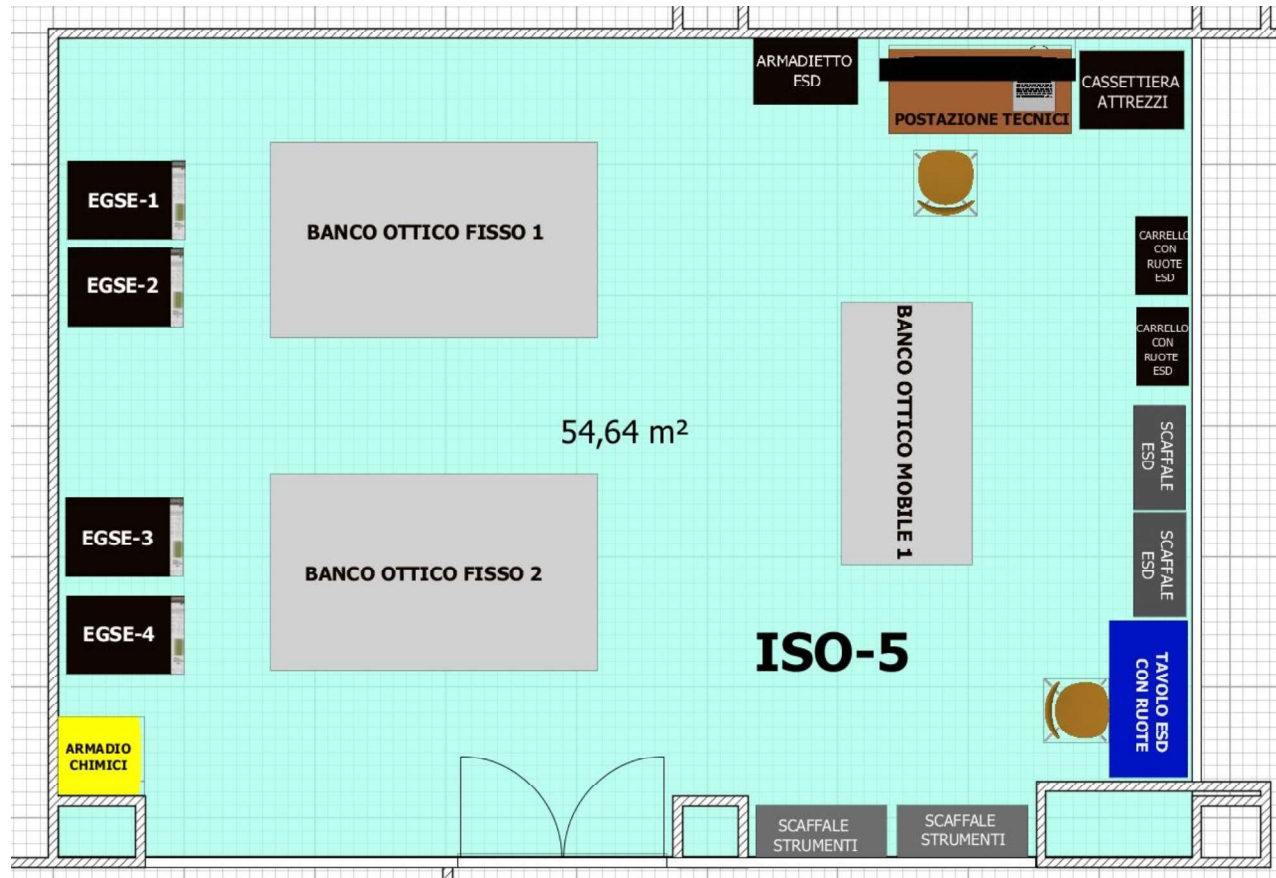

Lab Integrazione Payload – ISO 7

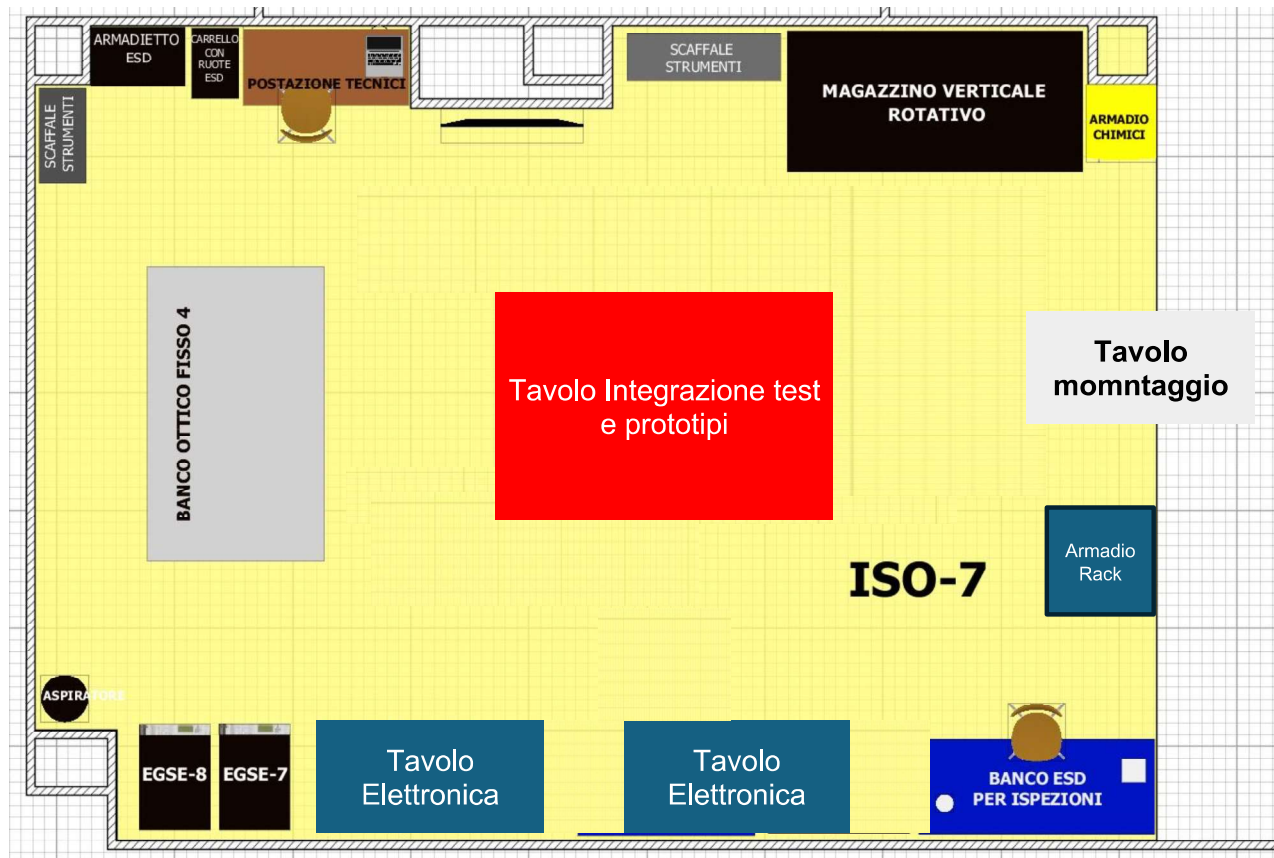

Lab MIC, PCBA – ISO 7

DRAFT

